

12 DE OUTUBRO
**DIA DAS
CRIANÇAS**



**Pequenos Sonhos, Grandes Corações:
O Futuro da Saúde Começa Agora!**



sac@medsonda.com.br



+ 55 43 3512 2800



www.medsonda.com.br

**CATÁLOGO DE PREÇOS
OUTUBRO 2025**



POLÍTICA DA QUALIDADE

A MEDSONDA tem como compromisso:

- ✓ Produzir e comercializar produtos hospitalares descartáveis que atendam as necessidades dos clientes;
- ✓ Buscando a melhoria contínua de nossos produtos e processos;
- ✓ Gerenciando os riscos em todo o ciclo de vida do produto, através de controles que assegurem a eficácia do uso pretendido;
 - ✓ Com comprometimento de nossos colaboradores;
 - ✓ Em harmonia com o meio ambiente;
- ✓ Atendendo a legislação e normas aplicáveis.



MEDSONDA
Produtos para saúde





INFORMAÇÕES IMPORTANTES	01
REPRESENTANTES DE A-G	02
REPRESENTANTES DE M-P	03
REPRESENTANTES DE R-T	04
ATENDIMENTO REGIONAL VENDAS	05
ATENDIMENTO REGIONAL COBRANÇA E LICITAÇÕES	06
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL	07
TORNEIRA 3 VIAS	09
LINHA DE SONDAS E CATETERES	10
LINHA DE CATETERES	14
LINHA DE EXTENSORES	15
LINHA DE EQUIPOS MACRO	19
LINHA DE EQUIPOS MICRO	22
LINHA DE EQUIPO VETERINÁRIO	25
LINHA DE EQUIPOS MEDVIAS	26
LINHA DE EQUIPO CARBOXI E NUTRIÇÃO	28
LINHA DE EQUIPO PVC E TRANSFERIDOR	29
LINHA DE EQUIPO ADAPTADOR E FRASCOS	30
LINHA DE EQUIPOS PARA ARTROSCOPIA	31
LINHA DE FOTOSSENSÍVEIS	32
LINHA DE FOTOSSENSÍVEIS E ROMPEDOR	33
LINHA DE DISPOSITIVOS	34
LINHA DE COLETORES E BOLSAS	36
LINHA DE TAMPAS E PRENEDORES	40
LINHA DE ESPÉCULOS E PINÇAS	41
LINHA DE ISOLADORES	42



IMPOSTOS

- T 1 - Tabela de Preços 1 - PARA COMPRAS DE R\$ 0 Á R\$ 500,00
 T 2 - Tabela de Preços 1 - PARA COMPRAS DE R\$ 500,00 Á R\$ 2.500,00
 T 3 - Tabela de Preços 1 - PARA COMPRAS DE R\$ 2.500,00 Á R\$ 5.000,00
 T 4 - Tabela de Preços 1 - PARA COMPRAS DE R\$ 5.000,00 Á R\$ 10.000,00
 T 5 - Tabela de Preços 1 - PARA COMPRAS ACIMA DE R\$ 10.000,00 (PAGAMENTO A VISTA)

CFIPI	DESCRIÇÃO
3006.91.10	BOLSA DRENAGEM/COL. GARRAFA/LINHA DE SANGUE
3006.91.10	BOLSA COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA E UROSTOMIA
3006.91.10	DISP./COL. INF. E CORDÃO
3917.40.90	TAMPA LUER
9018.39.29	SONDAS
9018.39.29	CATETERES
9018.39.99	EQUIPOS/EXTENSOR
9018.90.95	PRENDEDOR UMBILICAL
9018.90.99	ESPÉCULO VAGINAL
9021.10.10	ARTIGOS E APARELHOS ORTOPÉDICO
9021.90.19	ISOLADOR DE PRESSÃO
9018.39.21	CÂNULAS E DRENOS
4015.11.00	LUVAS CIRÚRGICAS
3005.10.90	CURATIVOS, GAZES E ATADURAS

OBS: A INSENÇÃO E AS ALIQUOTAS DOS PRODUTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1.980/07- ITEM 57 - ANEXO I - E CONVÊNIO 01/99 PARA O ICMS E DECRETO Nº 5.426/08 - ART. 1 - INCISO 3º - ANEXO III PARA PIS/PASEP E CONFINS.

DEVOLUÇÕES

“DEVOLUÇÕES, TROCAS E CANCELAMENTOS SOMENTE SERÃO ACEITOS COM MANIFESTAÇÃO ATÉ 7 DIAS APÓS DATA DE RECEBIMENTO, SALVO MERCADORIAS COM DESVIO DE QUALIDADE CONFIRMADOS E AUTORIZADOS PREVIAMENTE PELA MEDSONDA”

ENTREGA


**PRAZO E CONDIÇÕES DE
 ENTREGA
 SOB
 CONSULTA**

Acre

Elcio/Emanuel Representações Ltda.
Celular/Whatsapp :(69)9 9359 9788 (Claro)
E-mail: (1): elcio.sousa@uol.com.br
E-mail: (2): elciobsousa@yahoo.com.br

Alagoas

Representante: Clean Med Representação Ltda.
E-mail: cleanmed@cleanmed-farm.com.br
Contato : Denilson Andrade
Contatos: (79)99199 4533 / (79)99638 8501 

Amazonas

Representante: VALDERLI JONATHA L. RAMOS PINHO
E-mail : Val_john@hotmail.com
resolv.business@yahoo.com.br
Contatos: (92) 3613-4248

Bahia

Representante: MAXIMED - REPRESENTAÇÕES LTDA.
Contato: Franclin
Cel: (75) 99132-7383 – Tim(Whatsapp) - Franclin
Cel: (75) 98853-7383 – Claro - Franclin
Email: medsondabahia@gmail.com

Ceará

Representante: REPFOR - Representações Comerciais Ltda
E-mail: repfor2013@yahoo.com.br
Contatos: (85) 3281 6092 / (85) 98893 2885
Sr. Ronaldo Aragão

Distrito Federal

Representante: Rio Representações e Com.
Contato: José Raimundo
E-mail: jotaray@gmail.com
Contatos: (61) 3543 8688 | (61) 98101 6794

Espírito Santo

Representante: GIII Comércio e Repres.
E-mail: afraniorocha@gmail.com
Contatos: (27) 99948 7441

Goiás

Representante: HIPOMÉDICA REPRESENTAÇÕES - ANTÔNIO
E-mail: contato@hipomedica.com.br
pimenta@hipomedica.com.br
Contatos: (62)3095 2352

Maranhão

Representante: VEROLME COM. SEV. E REPRESENTAÇÃO LTDA
Contato : Valdeci
E-mail: verolme@hotmail.com.br
Contatos: (86)3225 2879 / (86) 99987 2301

Mato Grosso

Representante: LUCIA HELENA SOARES FALCÃO
E-mail : luciafalcao.br@gmail.com
Contatos: (65) 99982-0350 / (65) 3628-1690

Minas Gerais

Representante: Dumed Representações LTDA
Contato: Eduardo
E-mail : eduardo@dumed.com.br
Contatos: (31) 99456 2103 | (31) 4042 5343

Pará

Representante: NASCIMENTO E CIA
Contato: Paulo José Cartaxo Ribeiro
E-mail : pcartaxo05@yahoo.com
 cartaxorep@gmail.com
Contatos: (91) 3266 9563 | (91) 98807 0217

Pernambuco

Representante: CONEXÃO COMERCIAL REPR. FARMACÊUTICAS LTDA
Contato: Diego
E-mail : truta.diego@hotmail.com
Contatos: (81) 98785-2121 | (81) 98288-2125

Piauí

Representante: VEROLME COM. SEV. E REPRESENTAÇÃO LTDA
Contato : Valdeci
E-mail: verolme@hotmail.com.br
Contatos: (86) 3225 2879 | (86) 99987 2301

Paraná

Representante: ACP CORRÊA & CIA
Email: acphospitalar@uol.com.br
Contato: Leonardo
Telefones: (43) 99972 - 4151 | (43) 3242 - 1589



Rondônia

Elcio/Emanuel Representações Ltda.
Celular/Whatsapp : (69)9 9359 9788 (Claro)
E-mail: (1): elcio.sousa@uol.com.br
E-mail: (2): elciobsousa@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

Representante: DKDJ REPRESENTAÇÕES - DENNIS
SAFADI PINHEIRO
E-mail: dkdj@uol.com.br
Contatos: Nextel : (21)96422-3251
 ID Nextel : 35*16* 62366
 Tim : (21)99613 1710
Skype: denis.safadi.pinheiro

Roraima

Representante: MEDTEC
E-mail: medtec@medtechospitalar.com.br
Contatos: Tel: (95)36233782
Fax: (95)32241156
Sr. Nilmar Fogassi

Rio Grande do Sul

Representante: DIOGENES IORIS COM. E REPRESENTAÇÕES
E-mail: diogenes.ioris@uol.com.br
Contatos: (51) 9986 9925 | (51) 3472 1571

Rio Grande do Norte

Representante: MADSON WESLEY DA SILVA
E-mail: mwesley.sp@gmail.com
Contatos: (84) 98857.7364/3664.3398

Representante: Oliveira Repr. de Medic. Ltda - M
Contato: Franklin de Oliveira
E-mail: oliveira_representacoes@hotmail.com
Celular: (84) 9961-3297 OU (84) 9933-5303
Fone/Fax: (84) 3088-0950/(84) 3661-5609

Sergipe

Representante: Clean Med Representação Ltda.
E-mail: cleanmed@cleanmed-farm.com.br
Contato : Denilson Andrade
Contatos: (79)99199 4533 / (79)99638 8501 

São Paulo

Representante: JULIO CESAR
E-mail: jccaballero@uol.com.br
 caballerofilho@uol.com.br
Contatos (11) 99428 -6774 / (11) 5021-5413

São Paulo

Representate: RIBERNATU - CELSO - SP
E-mail: celsomedsonda@yahoo.com.br
Contatos: (16) 9795-1287

ATENDIMENTO MEDSONDA - LIGUE - (43) 3512 2800 - APÓS DIGITE O RAMAL DESEJADO

KAROLINA OTT

vendas6@medsonda.com.br

ESTADOS ATENDIDOS

Distrito Federal
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Santa Catarina
Roraima
Goiás (Dupatri)

RAMAL (2815)

SIMONE ZEZZI

vendas01@medsonda.com.br

ESTADOS ATENDIDOS

São Paulo
(Capital e Interior)
Rio Grande do Sul
Rondônia
Acre

RAMAL (2808)

SILMARA RODRIGUES

vendas2@medsonda.com.br

ESTADOS ATENDIDOS

Paraná
Pernambuco
Pará
Amapá
Amazonas

RAMAL (2825)

JULIANA SOARES BUENO

vendas03@medsonda.com.br

ESTADOS ATENDIDOS

Rio Grande do Norte
Paraíba
Alagoas
Bahia
Minas Gerais
Sergipe

RAMAL (2818)

ALESSANDRA COSTA

vendas5@medsonda.com.br

ESTADOS ATENDIDOS

Rio de Janeiro
Espírito Santo
Ribeirão Preto (Nacional)
Medicamental

RAMAL (2822)

KAMYLE MENDES

Cobrança | Vendas

licitacoes2@medsonda.com.br

ESTADOS ATENDIDOS

Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

RAMAL (2824)

MARCO A. FILHO

marco@medsonda.com.br

GERENTE COMERCIAL

RAMAL (2814)

MEDSONDA

cobranca@medsonda.com.br

RAMAL (2823)

ATENDIMENTO REGIONAL SAC

LUDMILA SOUSA DE LIMA

SAC

sac@medsonda.com.br

RAMAL (2810)



SAC

sac@medsonda.com.br
(43) 3512 2800





FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML ESTÉRIL

- Os frascos para administração de nutrição enteral MEDSONDA, são desenvolvidos em polietileno de alta qualidade, graduados com escala e com trava de segurança e alça de sustentação.

- Artigo médico-hospitalar de uso único, indicado para alimentação enteral de pacientes impossibilitados de deglutir o alimento.

- Frasco confeccionado em PE de 300ml graduado.

- Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570049

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK

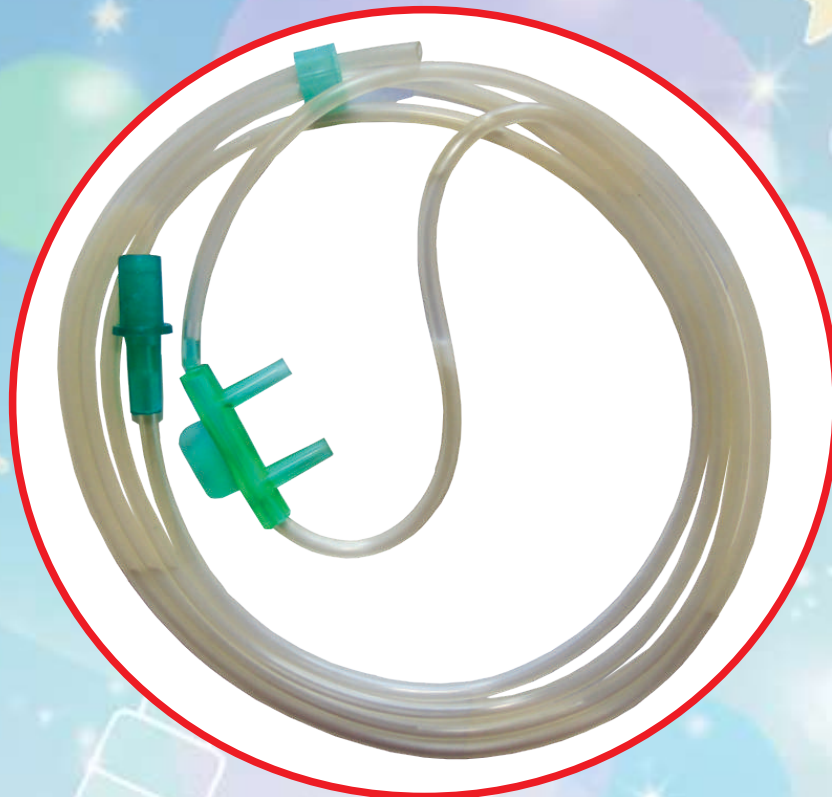
A torneira Descartável de 3 Vias é utilizada para conexão de acesso intravenoso para monitoração invasiva de pressão e administração de líquido, fármacos e retirada de amostras, sendo utilizado pelos profissionais da área médico-hospitalar.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163579005

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EMBALADO EM TERMOFORMADORA



CATETER NASAL TIPO ÓCULOS

- Destinado a aplicação de oxigênio medicinal auxiliando na respiração do paciente, é confeccionado em PVC (Policloreto de Vinil) cristal, com maior flexibilidade, uso adulto, transparente, flexível e atóxico com **TAMANHO DE 110CM.**

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570002

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EMBALADO EM TERMOFORMADORA

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL


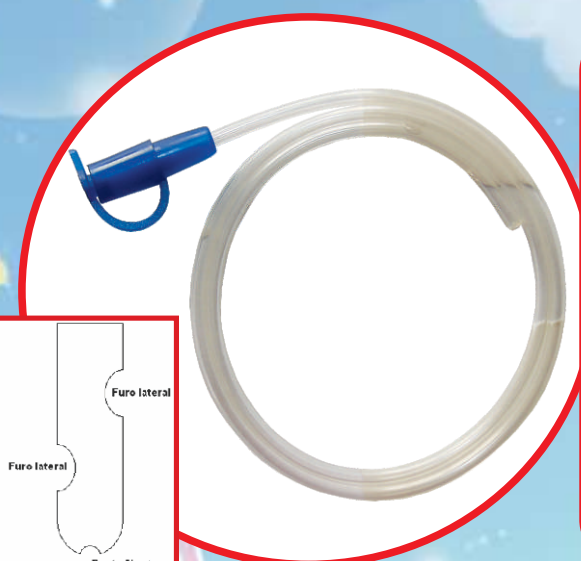
-Destinado a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções e entubados ou ainda traqueostomizados , é confeccionada em PVC (policloreto de vinil), comprimento de 48 cm cada unidade, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570005

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

TAMANHOS: 04/06/08/10/12 EMBALADO EM TERMOFORMADORA


**SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DIGITAL**

-Destinado a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções e entubados ou ainda traqueostomizados , é confeccionada em PVC (policloreto de vinil), comprimento de 40 cm para as sondas de tamanho 04 á 08, e 48cm para as sondas de tamanho 10 á 20, produto transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570005

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



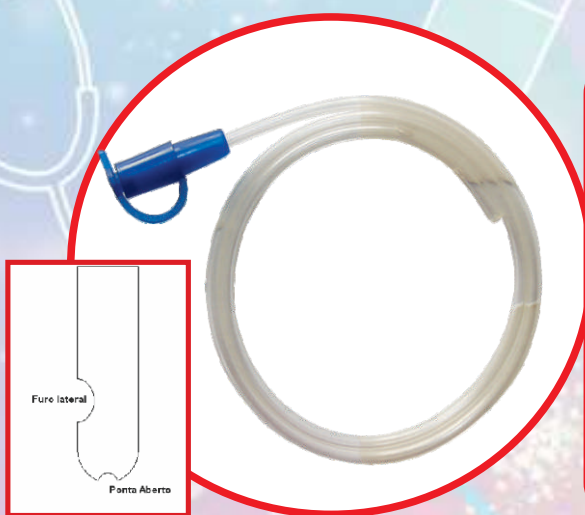
SONDA GÁSTRICA LEVINE

-Destinado a coletar amostras do conteúdo gástrico de adultos e crianças para a realização de estudos laboratoriais e administrar medicamentos e alimentação dentro do trato gastrointestinal, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 120 cm cada unidade, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570009

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

SONDA RETAL

-Destinado a aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso, utilizada também para a retirada de conteúdo fecal através do reto, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 40 cm cada unidade, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570004

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

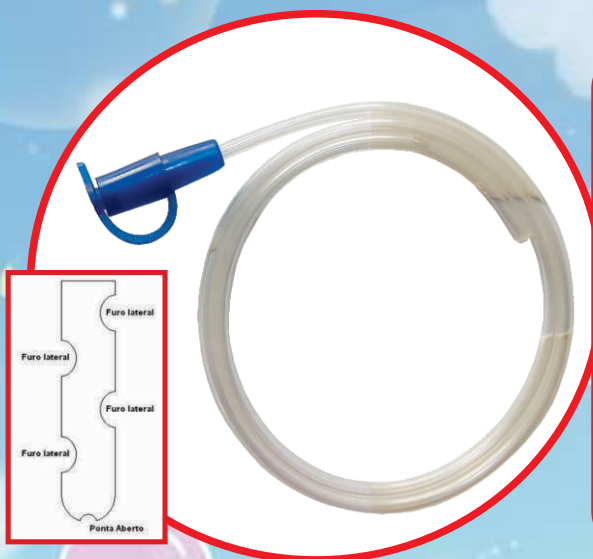
SONDA NASOGÁTRICA LONGA

-Destinado a coletar amostras do conteúdo gástrico de adultos e crianças para a realização de estudo laboratoriais e administrar medicamentos e alimentação dentro do trato gastrintestinal, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 110 cm cada unidade, transparente, flexível, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570003

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

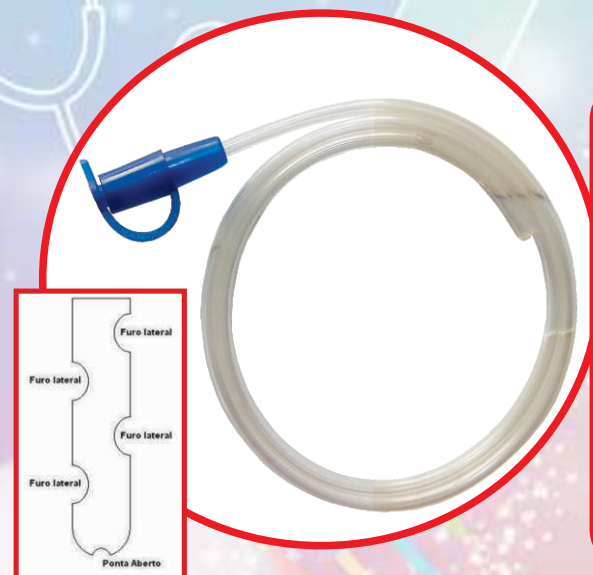
**SONDA NASOGÁTRICA CURTA**

-Destinado a coletar amostras do conteúdo gástrico de adultos e crianças para a realização de estudos laboratoriais e administrar medicamentos e alimentação dentro do trato gastrointestinal, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 40 cm cada unidade, atóxico, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570003

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



SONDA URETRAL

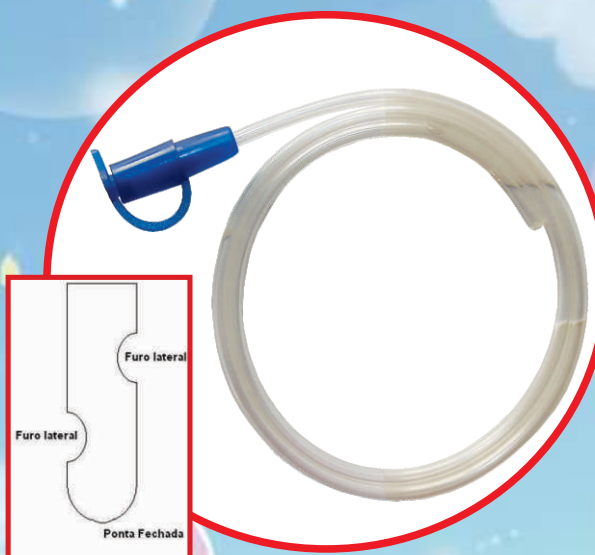
- Produto destinado a drenagem de urina na uretra do paciente, é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), comprimento de 40cm cada unidade, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570001

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

TAMANHOS: 04/06/08/10/12 EMBALADO EM TERMOFORMADORA

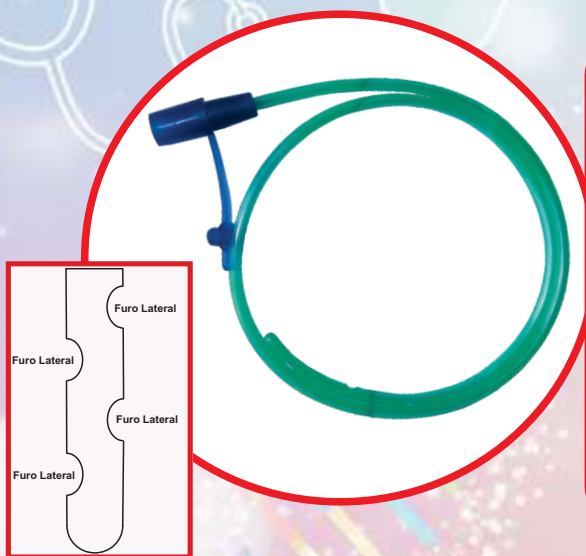
**CATETER NASAL OXIGÊNIO**

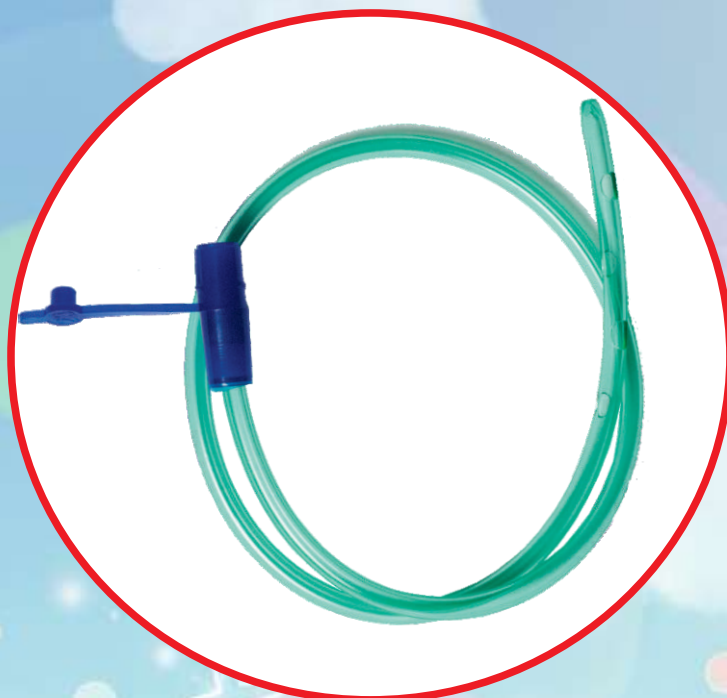
-Destinado a aplicação de oxigênio nos pulmões do paciente combatendo a deficiência de oxigênio facilitando a expectoração, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 40 cm cada unidade, verde, produto transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570002

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



**CATETER NASAL NEO NATAL E INFANTIL**

Cateter utilizado para administrar concentrações baixas e moderadas de oxigênio medicinal, é confeccionado em PVC (policloreto de vinil) cristal, com maior flexibilidade, uso NEO NATO E INFANTIL, verde, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570002

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

**SAC**

sac@medsonda.com.br
(43) 3512 2800



EXTENSOR PARA CATETER DE INFUSÃO

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), transparente, flexível e atóxico.

EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163579003

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EXTENSOR PARA CATETER INFUSÃO COM LUER ROTATIVO

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), com calibre na, transparente, flexível e atóxico.

EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163579003

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

**EXTENSOR CATETER INFUSÃO
COM CORTA FLUXO**

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), transparente, flexível e atóxico.

**EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO
POR GRAVIDADE.**

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163579003

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

**EXTENSOR CATETER INFUSÃO COM
LUER ROTATIVO E CORTA FLUXO**

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), transparente e flexível, transparente, flexível e atóxico.

**EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO
POR GRAVIDADE.**

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163579003

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EXTENSOR CATETER INFUSÃO NEO NATO

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão, é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), transparente e flexível com calibre na opção: neo nato, atóxico.

EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163579003

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EXTENSOR CATETER INFUSÃO INFUSÃO

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), transparente e flexível com calibre na opção: infantil, atóxico.

EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163579003

EXTENSOR ASPIRAÇÃO CRISTAL

-Extensor para aspiração cirúrgica, propicia maior liberdade de movimento e manipulação, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) com adaptador anelado ou ponteiros para adaptação, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570045 - ANELADO

ANVISA Nº 80163570007 - PONTEIRA

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

**ANELADO****PONTEIRA****EXTENSOR OXIGÊNIO VERDE**

-Oxigênio verde é destinada a prolongar a tubulação de pacientes usuários de cateter tipo sonda, confeccionada de tubo PVC, verde, com conector anelado, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

O Conector anelado permite conexão com os tubos de calibre 14mm, 16mm e 20mm.

ANVISA Nº 80163570007

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



**COM LUER
SLIP****EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PARTICULAS ENT. DE AR INJ. LAT. VALVULADO**

Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante que se adapta com facilidade a qualquer frasco, ampola, bolsa, com câmara de macro gotejamento flexível, modelo com filtro e injetor lateral valvulado.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX

**COM LUER
ROTATIVO**

Saúde



Compulsório



Saúde



Compulsório

**COM LUER
SLIP****EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PARTICULAS ENT. DE AR INJ. LAT. VALVULADO**

Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante que se adapta com facilidade a qualquer frasco, ampola, bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível, modelo com filtro e injetor lateral valvulado.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX

**COM LUER
ROTATIVO**

Saúde



Compulsório



Saúde



Compulsório



CONFIRA ABAIXO NOSSA LINHA DE EQUIPOS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MACRO GOTAS.

APROVADOS DEVIDAMENTE PELA PORTARIA Nº 461 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA EQUIPOS DE USO ÚNICO DE TRANSFUSÃO, INFUSÃO GRAVITACIONAL E DE INFUSÃO PARA USO COM BOMBA DE INFUSÃO - CONSOLIDADO.

**EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PARTICULAS E CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola /bolsa, com câmara de macro gotejamento flexível, modelo com filtro de partículas.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX



**EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PARTICULAS INJ. LAT. CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, contém injetor lateral que permite administrar múltiplos medicamentos.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX

**EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PARTICULAS ENT. DE AR CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, com entrada de ar.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX



**EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PART. INJ. LAT. ENT. AR CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco/ampola/bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, contém injetor lateral que permite administrar múltiplos medicamentos.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX

**EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO
PARTICULAS ENT. DE AR E CONECTOR LUER ROTATIVO**

-Equipo utilizado para infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, com entrada de ar, contém injetor lateral que permite administrar múltiplos medicamentos.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX



CONFIRA ABAIXO NOSSA LINHA DE EQUIPOS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MICRO GOTAS.

APROVADOS DEVIDAMENTE PELA PORTARIA Nº 461 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA EQUIPOS DE USO ÚNICO DE TRANSFUSÃO, INFUSÃO GRAVITACIONAL E DE INFUSÃO PARA USO COM BOMBA DE INFUSÃO - CONSOLIDADO.

**EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PARTICULAS CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco/ampola/bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX



**EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PARTICULAS INJ. LAT. CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante trifacetado que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX

**EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PARTICULAS ENT. DE AR CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante trifacetado que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível com injetor lateral para administrar vários medicamentos.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX



**EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PARTICULAS ENT. AR INJ. LAT. LUER SLIP**

-Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível, entrada de ar e injetor lateral.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX

**EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL
FILTRO PART. ENT. DE AR INJ. LAT. CONEC. LUER ROT.**

-Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível, entrada de ar, injetor lateral e conector luver rotativo.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

PRODUTO LIVRE DE LATEX



EQUIPO VETERINÁRIO

- Equipo de infusão por gravidade com ou sem injetor lateral, para administração de medicamentos veterinários, com ponta perfurante, controle de fluxo e câmara de gotejamento transparente.

PRODUTO ESTÉRILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO

ANVISA Nº ISENTO DE REGISTRO

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

2 VIAS**MEDVIAS 2 E 4 VIAS CORTA FLUXO TAMPA RESERVA E CONECTOR LUER ROTATIVO**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570041

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EMBALADO EM TERMOFORMADORA

4 VIAS

**SEM CORTA
FLUXO****MEDVIAS COM 2 VIAS**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570041

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EMBALADO EM TERMOFORMADORA

**COM CORTA
FLUXO****SEM CORTA
FLUXO****MEDVIAS COM 4 VIAS**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570041

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA
EMBALADO EM TERMOFORMADORA

**COM CORTA
FLUXO**

**SEM CORTA
FLUXO****MEDVIAS COM 2 VIAS NEO NATO**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570041

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EMBALADO EM TERMOFORMADORA

**COM CORTA
FLUXO****SEM CORTA
FLUXO****MEDVIAS COM 4 VIAS NEO NATO**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570041

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

**COM CORTA
FLUXO**

**COM LUER
ROTATIVO****NEO NATO
LUER SLIP****MEDVIAS 2 E 4 VIAS CORTA FLUXO
VÁLVULADO**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570041

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

MODELO I**EQUIPO PARA CARBOXITERAPIA**

- Equipamento usado para estética não cirúrgica, na qual o gás carbônico é injetado utilizando-se de aparelho com agulha muito fina indicada para o combate da celulite, estrias, flacidez, gordura localizada, olheiras, rugas, micro varizes.

-Esterilizado por óxido de etileno.

ANVISA Nº 80163579004

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EMBALADO EM TERMOFORMADORA

MODELO II**Conector
Escalonado****EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL**

-Produto destinado à nutrição enteral. Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa. Sua câmara de gotejamento é macro flexível nos modelos com conector luer slip e escalonado.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570026

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

**Conector
Luer Slip**

EQUIPO PRESSÃO VENOSA

-Equipo pressão venosa central P.V.C, estéril com câmara gotejadora e tubo interligado em forma de Y, pinça tipo rolete, acompanha fita graduada adesiva. E embalado individualmente, P.G.C de 1,80cm e fita métrica de 40cm.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570044

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EQUIPO TRANSFERIDOR SISTEMA FECHADO

- Destinado a utilização para transferência e misturar soluções parenterais em sistema fechado, com duas pontas perfurantes com protetor.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº80163570027

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA
EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

**EQUIPO IRRIGADOR SISTEMA
FECHADO 10CM**

-Dispositivo para irrigação ou transferência de soluções parenterais, para uso em frascos de sistema fechado, com uma ponta perfurante padrão ISO com protetor e outra ponta com protetor que garanta a oclusão do sistema após o uso; único canal para fluxo do líquido e pega ergonômica para manipulação.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570050

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA
EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

DEVOLUÇÕES

“DEVOLUÇÕES, TROCAS E CANCELAMENTOS SOMENTE SERÃO ACEITOS COM MANIFESTAÇÃO ATÉ 7 DIAS APÓS DATA DE RECEBIMENTO, SALVO MERCADORIAS COM DESVIO DE QUALIDADE CONFIRMADOS E AUTORIZADOS PREVIAMENTE PELA MEDSONDA”

**SAC**

sac@medsonda.com.br
(43) 3512 2800

EQUIPO IRRIGADOR SISTEMA FECHADO

- Dispositivo para irrigação, com ponta perfurante padrão ISO, com protetor e tampa luer lock.
- Embalagem individual, abertura em pétala, esterilizada em óxido de etileno, com data de esterilização, prazo de validade e registro em

ANVISA Nº 80163570050**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA****EMBALADO EM TERMOFORMADORA****FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL**

- Os frascos para administração de nutrição enteral **MEDSONDA** são desenvolvidos em polietileno de alta qualidade, graduados com escala e com trava de segurança e alça de sustentação.
- Artigo médico-hospitalar de uso único, indicado para alimentação enteral de pacientes impossibilitados de deglutir o alimento.

Frasco confeccionado em PE de 300ml graduado.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL**ANVISA Nº 80163570036****PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

EQUIPO PARA ARTROSCOPIA

- Utilizado para irrigar com solução fisiológica o órgão a ser submetido à Artroscopia.
- Produto composto por extensões em PVC cristal atóxico, conectores em "Y", clamp, corta fluxo em todas as vias.
- Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570034**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA****EQUIPO MACRO FLEX. INJ. LAT. ENT. AR FOTOSSENSÍVEL**

-O Equipo de infusão gravitacional fotossensível é um produto foto-protetor, ele é indicado para a infusão de medicamentos, sensíveis a luz, os mesmos sofrem alterações em suas propriedades originais sob a ação, dos raios ultra violetas da luz, possui ponta perfurante que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, contém injetor lateral e filtro partícula, entrada de ar hidrofóbica acompanha capa para frascos que contenham soluções fotossensíveis.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570037**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA****CAPA****LUER SLIP****CAPA**

**EXTENSOR CATETER INFUSÃO
FOTOSSENSÍVEL**

-O Extensor Fotossensível é um produto foto-protetor, ele é indicado para extensão de equipos onde sua propriedade é a infusão de medicamentos fotossensíveis, ou seja sensíveis a luz, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão, é flexível com calibre na opção, adulto Fr12.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570032

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

**2 VIAS CORTA
FLUXO****MEDVIAS 2 E 4 VIAS FOTOSSENSÍVEL**

-Extensor fotossensível, utilizado para multiplicação à via de acesso, permitindo assim, a infusão simultânea de 2 a 4 tipos de medicamentos sensíveis a luz, embalado individualmente, esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com especificações a critério de sua utilização.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570039

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA
EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

**4 VIAS CORTA
FLUXO**



ROMPEDOR PARA MEMBRANA AMNIÓTICA 27CM

-O perfurador de membrana amniótica oferece um método seguro e confortável para romper a membrana amniótica.
-Com 27cm, possui ponta arredondada e protegida.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163579006

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM EXTENSÃO

- Indicado para coleta da urina de pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária.

ANVISA Nº 80163570030 - Não Estéril
ANVISA Nº 80163570028 - Estéril

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA TIPO CONE

- Indicado a coleta da urina de pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária.

ANVISA Nº 80163570030 - Não estéril

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



BOLSA DRENAGEM URINA SISTEMA FECHADO PERNA 750ML

-Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese de um paciente. Embalagem individual com todos os dados necessários ao usuário, tais como: identificação, marca, instrução de uso, número de lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570014

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

COLETOR URINA SISTEMA ABERTO NÃO ESTÉRIL TIPO SACO 2.000ML



-Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese do paciente.

ANVISA Nº 80163570046

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

COLETOR URINA INFANTIL ADESIVO TIPO SACO 100ML



-Produto destinado a coletar material para exames, confeccionado com saco de 17cm de comprimento e 10 cm de largura, nos formatos masculino, feminino e unissex.

ANVISA Nº 80163570029 - NÃO ESTÉRIL
ANVISA Nº 80163570021 - ESTÉRIL

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

SEM PRESERVATIVO



COM PRESERVATIVO

**COLETOR SISTEMA ABERTO TIPO
GARRAFA 1.200ML**

- Produto destinado para drenagem de urina, embalagem individual com todos os dados necessários ao usuário como : Identificação, marca, instruções de uso, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.

ANVISA Nº 80163570008 - Sem Preservativo

ANVISA Nº 80163570043 - Com Preservativo

PRODUTO NÃO ESTÉRIL

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



BOLSA DRENAGEM URINA SISTEMA FECHADO STANDARD

-Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese de um paciente.
-Embalagem individual com todos os dados necessários ao usuário, tais como: identificação, marca, instrução de uso, número de lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570014

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



BOLSA DRENAGEM DE URINA COM CÂMARA DE PASTEUR 2.000ML

-Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese de um paciente possui câmara de PASTEUR.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570014

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

COLETOR SISTEMA ABERTO TIPO BOLSA 1.500ML



-Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese de um paciente.

Produto NÃO ESTÉRIL

ANVISA Nº 80163570047

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

BOLSA PARA COLOSTOMIA



-Produto destinado a utilização da saída de dejetos fecais no final do intestino, que está com sua saída diferente do reto, devido a realização de cirurgia corretiva de tumores ou obstruções que exigem manipulação, confeccionado com furos nos tamanhos de 30, 50 e 63mm com capacidade de 200ml.

Produto NÃO ESTÉRIL, ANTI ALÉRGICO.

ANVISA Nº 80163570013

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

TAMPA LUER MED

-É uma tampa de proteção luer lock macho adaptado aos conectores luer lock fêmea com finalidade de vedação.

ABERTURA EM PÉTALA

ANVISA Nº 80163570020

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

EMBALADO EM TERMOFORMADORA

**PRENDEDOR UMBILICAL**

-Acessório utilizado para prender o cordão umbilical de recém nascidos, após o parto, uso profissional, e confeccionado em nylon, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570015

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA



ESPÉCULO

-Produto destinado a realização de exames ginecológicos, fabricado em polietileno cristal nos tamanhos P , M e G, permite excelente transparência e transmissão luminosa, estrutura anatômica de contornos lisos e regulares, estéril e descartável.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163579002

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

IPI INCLUSO

PINÇA DE CHERON

- A Pinça de Cheron é fabricada em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda.

ANVISA Nº 80163579007

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

ISOLADOR DE PRESSÃO

-É um acessório que tem como função transmitir a pressão da linha de sangue arterial ou venosa ao monitor de diálise, evitando assim a contaminação pelo sangue do paciente, é confeccionado em PVC, transparente, atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570016

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

**DEVOLUÇÕES**

“DEVOLUÇÕES, TROCAS E CANCELAMENTOS SOMENTE SERÃO ACEITOS COM MANIFESTAÇÃO ATÉ 7 DIAS APÓS DATA DE RECEBIMENTO, SALVO MERCADORIAS COM DESVIO DE QUALIDADE CONFIRMADOS E AUTORIZADOS PREVIAMENTE PELA MEDSONDA”

ENTREGA

**PRAZO E CONDIÇÕES DE
ENTREGA
SOB
CONSULTA**