

**MEDSONDA**  
Produtos para saúde

**10 DE MAIO**  
**DIA DAS MÃES**



[sac@medsonda.com.br](mailto:sac@medsonda.com.br)



+ 55 43 3512 2800



[www.medsonda.com.br](http://www.medsonda.com.br)

**CATÁLOGO**  
**MAIO 2026**



## POLÍTICA DA QUALIDADE

**A MEDSONDA tem como compromisso:**

- ✓ Produzir e comercializar produtos hospitalares descartáveis que atendam as necessidades dos clientes;
- ✓ Buscando a melhoria contínua de nossos produtos e processos;
- ✓ Gerenciando os riscos em todo o ciclo de vida do produto, através de controles que assegurem a eficácia do uso pretendido;
  - ✓ Com comprometimento de nossos colaboradores;
  - ✓ Em harmonia com o meio ambiente;
- ✓ Atendendo a legislação e normas aplicáveis.



**MEDSONDA**  
Produtos para saúde



**QUALIDADE**

**SGQ**  
**MEDSONDA**  
Produtos para saúde

Sistema de Garantia  
da Qualidade





<b>INFORMAÇÕES IMPORTANTES</b>	<b>01</b>
<b>REPRESENTANTES DE A-G</b>	<b>02</b>
<b>REPRESENTANTES DE M-P</b>	<b>03</b>
<b>REPRESENTANTES DE R-T</b>	<b>04</b>
<b>ATENDIMENTO REGIONAL VENDAS</b>	<b>05</b>
<b>ATENDIMENTO REGIONAL COBRANÇA E LICITAÇÕES</b>	<b>06</b>
<b>FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL</b>	<b>07</b>
<b>TORNEIRA 3 VIAS</b>	<b>09</b>
<b>LINHA DE SONDAS E CATETERES</b>	<b>10</b>
<b>LINHA DE CATETERES</b>	<b>14</b>
<b>LINHA DE EXTENSORES</b>	<b>15</b>
<b>LINHA DE EQUIPOS MACRO</b>	<b>19</b>
<b>LINHA DE EQUIPOS MICRO</b>	<b>22</b>
<b>LINHA DE EQUIPO VETERINÁRIO</b>	<b>25</b>
<b>LINHA DE EQUIPOS MEDVIAS</b>	<b>26</b>
<b>LINHA DE EQUIPO CARBOXI E NUTRIÇÃO</b>	<b>28</b>
<b>LINHA DE EQUIPO PVC E TRANSFERIDOR</b>	<b>29</b>
<b>LINHA DE EQUIPO ADAPTADOR E FRASCOS</b>	<b>30</b>
<b>LINHA DE EQUIPOS PARA ARTROSCOPIA</b>	<b>31</b>
<b>LINHA DE FOTOSSENSÍVEIS</b>	<b>32</b>
<b>LINHA DE FOTOSSENSÍVEIS E ROMPEDOR</b>	<b>33</b>
<b>LINHA DE DISPOSITIVOS</b>	<b>34</b>
<b>LINHA DE COLETORES E BOLSAS</b>	<b>36</b>
<b>LINHA DE TAMPAS E PRENEDORES</b>	<b>40</b>
<b>LINHA DE ESPÉCULOS E PINÇAS</b>	<b>41</b>
<b>LINHA DE ISOLADORES</b>	<b>42</b>



**IMPOSTOS**

- T 1 - Tabela de Preços 1 - PARA COMPRAS DE R\$ 0 Á R\$ 500,00
- T 2 - Tabela de Preços 1 - PARA COMPRAS DE R\$ 500,00 Á R\$ 2.500,00
- T 3 - Tabela de Preços 1 - PARA COMPRAS DE R\$ 2.500,00 Á R\$ 5.000,00
- T 4 - Tabela de Preços 1 - PARA COMPRAS DE R\$ 5.000,00 Á R\$ 10.000,00
- T 5 - Tabela de Preços 1 - PARA COMPRAS ACIMA DE R\$ 10.000,00 (PAGAMENTO A VISTA)

CFIPI	DESCRIÇÃO
3006.91.10	BOLSA DRENAGEM/COL. GARRAFA/LINHA DE SANGUE
3006.91.10	BOLSA COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA E UROSTOMIA
3006.91.10	DISP./COL. INF. E CORDÃO
3917.40.90	TAMPA LUER
9018.39.29	SONDAS
9018.39.29	CATETERES
9018.39.99	EQUIPOS/EXTENSOR
9018.90.95	PRENDEDOR UMBILICAL
9018.90.99	ESPÉCULO VAGINAL
9021.10.10	ARTIGOS E APARELHOS ORTOPÉDICO
9021.90.19	ISOLADOR DE PRESSÃO
9018.39.21	CÂNULAS E DRENOS
4015.11.00	LUVAS CIRÚRGICAS
3005.10.90	CURATIVOS, GAZES E ATADURAS

**OBS: A INSENÇÃO E AS ALIQUOTAS DOS PRODUTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1.980/07- ITEM 57 - ANEXO I - E CONVÊNIO 01/99 PARA O ICMS E DECRETO Nº 5.426/08 - ART. 1 - INCISO 3º - ANEXO III PARA PIS/PASEP E CONFINS.**

**DEVOLUÇÕES**

**“DEVOLUÇÕES, TROCAS E CANCELAMENTOS SOMENTE SERÃO ACEITOS COM MANIFESTAÇÃO ATÉ 7 DIAS APÓS DATA DE RECEBIMENTO, SALVO MERCADORIAS COM DESVIO DE QUALIDADE CONFIRMADOS E AUTORIZADOS PREVIAMENTE PELA MEDSONDA”**

**ENTREGA**



**PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**Acre**

**Elcio/Emanuel Representações Ltda.**  
**Celular/Whatsapp :**(69)9 9359 9788 (Claro)  
**E-mail:** (1): elcio.sousa@uol.com.br  
**E-mail:** (2): elciobsousa@yahoo.com.br

**Alagoas**

**Representante:** Clean Med Representação Ltda.  
**E-mail:** cleanmed@cleanmed-farm.com.br  
**Contato :** Denilson Andrade  
**Contatos:** (79)99199 4533 / (79)99638 8501 

**Amazonas**

**Representante:** VALDERLI JONATHA L. RAMOS PINHO  
**E-mail :** Val\_john@hotmail.com  
 resolv.business@yahoo.com.br  
**Contatos:** (92) 3613-4248

**Bahia**

**Representante:** MAXIMED - REPRESENTAÇÕES LTDA.  
**Contato:** Franclin  
**Cel:** (75) 99132-7383 – Tim(Whatsapp) - Franclin  
**Cel:** (75) 98853-7383 – Claro - Franclin  
**Email:** medsondabahia@gmail.com

**Ceará**

**Representante:** REPFOR - Representações Comerciais Ltda  
**E-mail:** repfor2013@yahoo.com.br  
**Contatos:** (85) 3281 6092 / (85) 98893 2885  
**Sr. Ronaldo Aragão**

**Distrito Federal**

**Representante:** Rio Representações e Com.  
**Contato:** José Raimundo  
**E-mail:** jotaray@gmail.com  
**Contatos:** (61) 3543 8688 | (61) 98101 6794

**Espírito Santo**

**Representante:** GIII Comércio e Repres.  
**E-mail:** afraniorocha@gmail.com  
**Contatos:** (27) 99948 7441

**Goiás**

**Representante:** HIPOMÉDICA REPRESENTAÇÕES - ANTÔNIO  
**E-mail:** contato@hipomedica.com.br  
 pimenta@hipomedica.com.br  
**Contatos:** (62)3095 2352

**Maranhão**

**Representante:** VEROLME COM. SEV. E REPRESENTAÇÃO LTDA  
**Contato :** Valdeci  
**E-mail:** verolme@hotmail.com.br  
**Contatos:** (86)3225 2879 / (86) 99987 2301

**Minas Gerais**

**Representante:** Dumed Representações LTDA  
**Contato:** Eduardo  
**E-mail :** eduardo@dumed.com.br  
**Contatos:** (31) 99456 2103 | (31) 4042 5343

**Pará**

**Representante:** NASCIMENTO E CIA  
**Contato:** Paulo José Cartaxo Ribeiro  
**E-mail :** pcartaxo05@yahoo.com  
 cartaxorep@gmail.com  
**Contatos:** (91) 3266 9563 | (91) 98807 0217

**Paraná**

**Representante:** ACP CORRÊA & CIA  
**Email:** acphospitalar@uol.com.br  
**Contato:** Leonardo  
**Telefones:** (43) 99972 - 4151 | (43) 3242 - 1589

**Pernambuco**

**Representante:** CONEXÃO COMERCIAL REPR. FARMACÊUTICAS LTDA  
**Contato:** Diego  
**E-mail :** truta.diego@hotmail.com  
**Contatos:** (81) 98785-2121 | (81) 98288-2125

**Piauí**

**Representante:** VEROLME COM. SEV. E REPRESENTAÇÃO LTDA  
**Contato :** Valdeci  
**E-mail:** verolme@hotmail.com.br  
**Contatos:** (86) 3225 2879 | (86) 99987 2301



**Rondônia**

**Elcio/Emanuel Representações Ltda.**  
**Celular/Whatsapp :**(69)9 9359 9788 (Claro)  
**E-mail:** (1): elcio.sousa@uol.com.br  
**E-mail:** (2): elciobsousa@yahoo.com.br

**Rio de Janeiro**

**Representante: DKDJ REPRESENTAÇÕES - DENNIS SAFADI PINHEIRO**  
**E-mail:** dkdj@uol.com.br  
**Contatos:** Nextel : (21)96422-3251  
 ID Nextel : 35\*16\* 62366  
 Tim : (21)99613 1710  
**Skype:** denis.safadi.pinheiro

**Roraima**

**Representante: MEDTEC**  
**E-mail:** medtec@medtechospitalar.com.br  
**Contatos:**Tel:(95)36233782  
**Fax:**(95)32241156  
**Sr. Nilmar Fogassi**

**Rio Grande do Sul**

**Representante: DIOGENES IORIS COM. E REPRESENTAÇÕES**  
**E-mail:** diogenes.ioris@uol.com.br  
**Contatos:** (51) 9986 9925 | (51) 3472 1571

**Rio Grande do Norte**

**Representante: MADSON WESLEY DA SILVA**  
**E-mail:** mwesley.sp@gmail.com  
**Contatos:**(84) 98857.7364/3664.3398

**Representante: Oliveira Repr. de Medic. Ltda - M**  
**Contato:**Franklin de Oliveira  
**E-mail:**oliveira\_representacoes@hotmail.com  
**Celular:**(84) 9961-3297 OU (84) 9933-5303  
**Fone/Fax:**(84) 3088-0950/(84) 3661-5609

**Sergipe**

**Representante: Clean Med Representação Ltda.**  
**E-mail:** cleanmed@cleanmed-farm.com.br  
**Contato :** Denilson Andrade  
**Contatos:** (79)99199 4533 / (79)99638 8501 

**São Paulo**

**Representante: JULIO CESAR**  
**E-mail:** jccaballero@uol.com.br  
 caballerofilho@uol.com.br  
**Contatos** (11) 99428 -6774 / (11) 5021-5413

**São Paulo**

**Representate: RIBERNATU - CELSO - SP**  
**E-mail:** celsomedsonda@yahoo.com.br  
**Contatos:** (16) 9795-1287

ATENDIMENTO MEDSONDA - LIGUE - (43) 3512 2800 - APÓS DIGITE O RAMAL DESEJADO

**KAROLINA OTT**

vendas6@medsonda.com.br

**ESTADOS ATENDIDOS**

Distrito Federal  
Tocantins  
Maranhão  
Piauí  
Ceará  
Santa Catarina  
Roraima  
Goiás (Dupatri)

**RAMAL (2815)**

**SIMONE ZEZZI**

vendas01@medsonda.com.br

**ESTADOS ATENDIDOS**

São Paulo  
(Capital e Interior)  
Rio Grande do Sul  
Rondônia  
Acre

**RAMAL (2808)**

**SILMARA RODRIGUES**

vendas2@medsonda.com.br

**ESTADOS ATENDIDOS**

Paraná  
Pernambuco  
Pará  
Amapá  
Amazonas  
Bahia

**RAMAL (2825)**

**ALESSANDRA COSTA**

vendas5@medsonda.com.br

**ESTADOS ATENDIDOS**

Rio de Janeiro  
Espírito Santo  
Ribeirão Preto (Nacional)  
Medicamental

**RAMAL (2822)**

**KAMYLE MENDES**

Licitações | Vendas

licitacoes2@medsonda.com.br

**ESTADOS ATENDIDOS**

Mato Grosso  
Mato Grosso do Sul  
Rio Grande do Norte  
Paraíba  
Alagoas  
Bahia  
Minas Gerais  
Sergipe

**RAMAL (2824)**

**MARCO A. FILHO**

marco@medsonda.com.br

**GERENTE COMERCIAL**

**RAMAL (2814)**



**MEDSONDA**

cobranca@medsonda.com.br

RAMAL (2823)

**ATENDIMENTO REGIONAL SAC**

**LUDMILA SOUSA DE LIMA**

**SAC**


sac@medsonda.com.br

RAMAL (2810)



**SAC**

sac@medsonda.com.br  
(43) 3512 2800

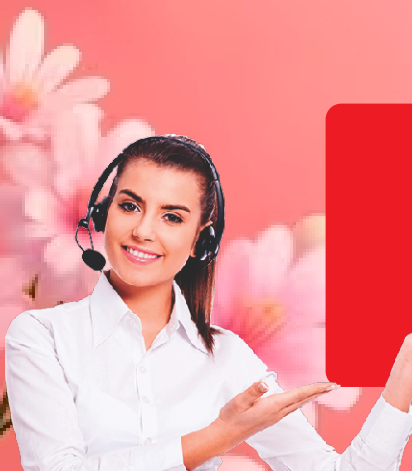



### FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML ESTÉRIL

- Os frascos para administração de nutrição enteral MEDSONDA, são desenvolvidos em polietileno de alta qualidade, graduados com escala e com trava de segurança e alça de sustentação.

- Artigo médico-hospitalar de uso único, indicado para alimentação enteral de pacientes impossibilitados de deglutir o alimento.

- Frasco confeccionado em PE de 300ml graduado.

- Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570049**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



### TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK


A torneira Descartável de 3 Vias é utilizada para conexão de acesso intravenoso para monitoração invasiva de pressão e administração de líquido, fármacos e retirada de amostras, sendo utilizado pelos profissionais da área médico-hospitalar.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163579005**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

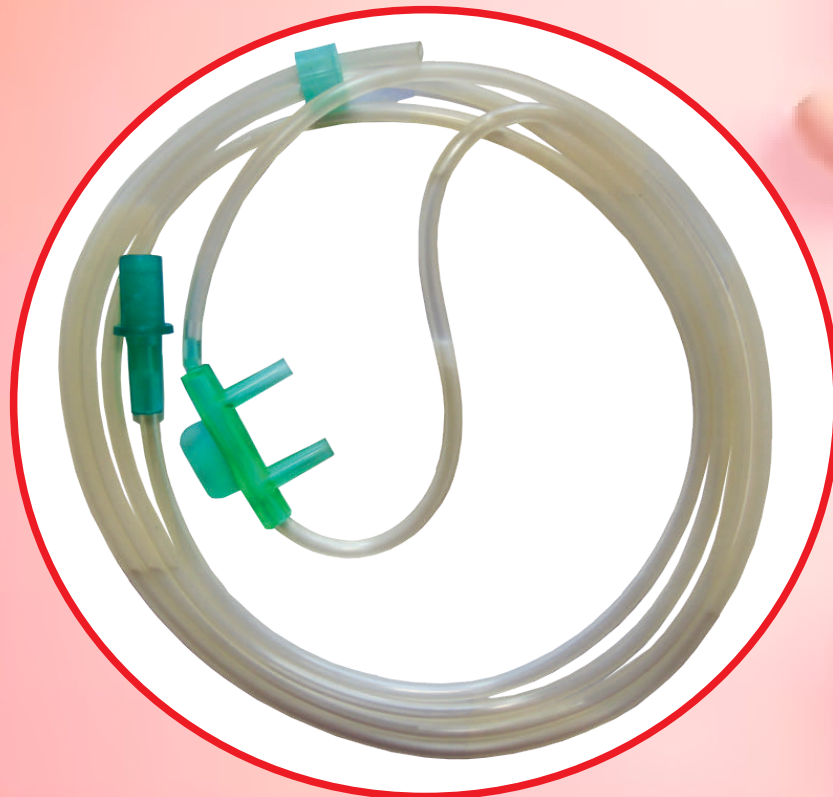

### CATETER NASAL TIPO ÓCULOS

- Destinado a aplicação de oxigênio medicinal auxiliando na respiração do paciente, é confeccionado em PVC (Policloreto de Vinil) cristal, com maior flexibilidade, uso adulto, transparente, flexível e atóxico com **TAMANHO DE 110CM.**

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570002**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

**SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL**



-Destinado a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções e entubados ou ainda traqueostomizados , é confeccionada em PVC (policloreto de vinil), comprimento de 48 cm cada unidade, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570005**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**TAMANHOS: 04/06/08/10/12 EMBALADO EM TERMOFORMADORA**


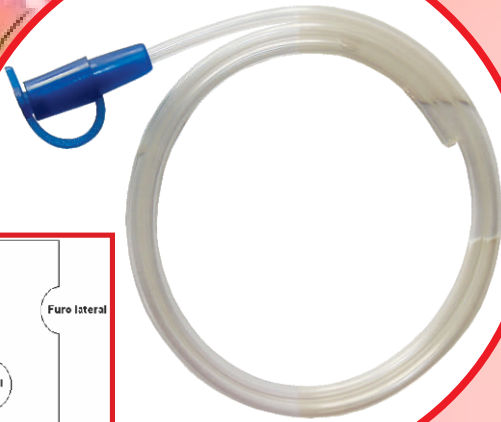
**SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DIGITAL**

-Destinado a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções e entubados ou ainda traqueostomizados , é confeccionada em PVC (policloreto de vinil), comprimento de 40 cm para as sondas de tamanho 04 á 08, e 48cm para as sondas de tamanho 10 á 20, produto transparente, flexível e atóxico.


-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570005**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

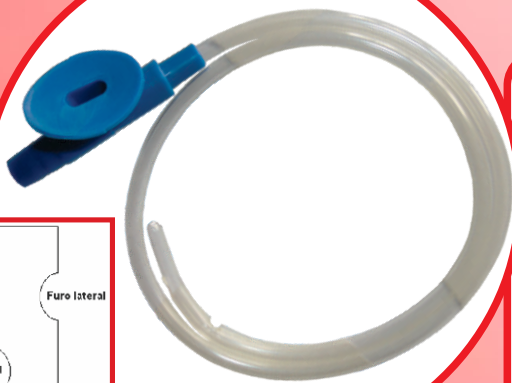

## SONDA GÁSTRICA LEVINE

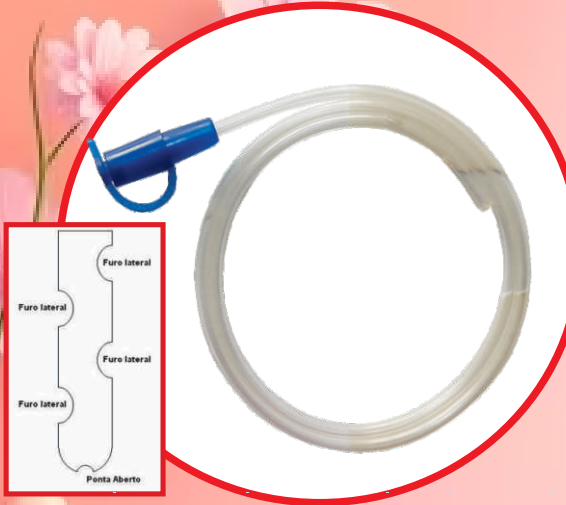


-Destinado a coletar amostras do conteúdo gástrico de adultos e crianças para a realização de estudos laboratoriais e administrar medicamentos e alimentação dentro do trato gastrointestinal, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 120 cm cada unidade, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570009**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

## SONDA RETAL

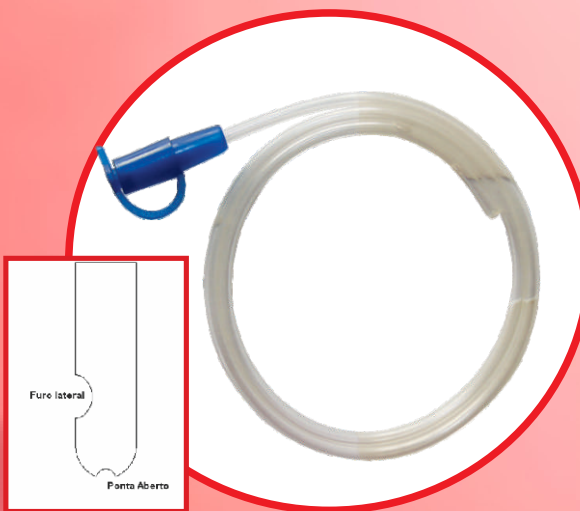

-Destinado a aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso, utilizada também para a retirada de conteúdo fecal através do reto, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 40 cm cada unidade, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570004**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



**SONDA NASOGÁTRICA LONGA**

-Destinado a coletar amostras do conteúdo gástrico de adultos e crianças para a realização de estudo laboratoriais e administrar medicamentos e alimentação dentro do trato gastrintestinal, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 110 cm cada unidade, transparente, flexível, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570003**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

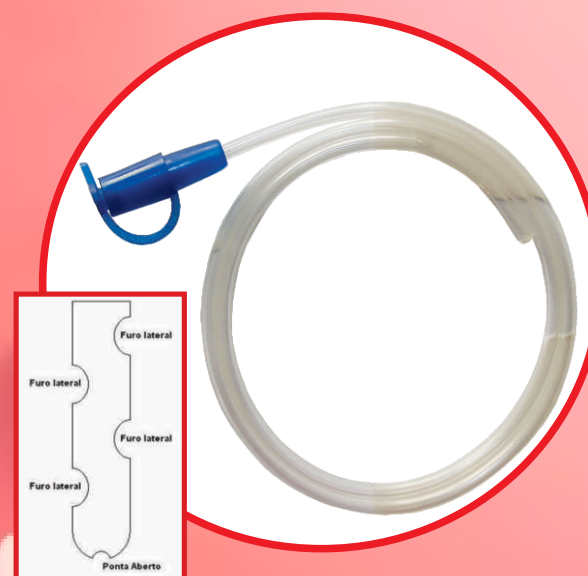**SONDA NASOGÁTRICA CURTA**

-Destinado a coletar amostras do conteúdo gástrico de adultos e crianças para a realização de estudos laboratoriais e administrar medicamentos e alimentação dentro do trato gastrointestinal, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 40 cm cada unidade, atóxico, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570003**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**SONDA URETRAL**



- Produto destinado a drenagem de urina na uretra do paciente, é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), comprimento de 40cm cada unidade, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570001**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**TAMANHOS: 04/06/08/10/12 EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

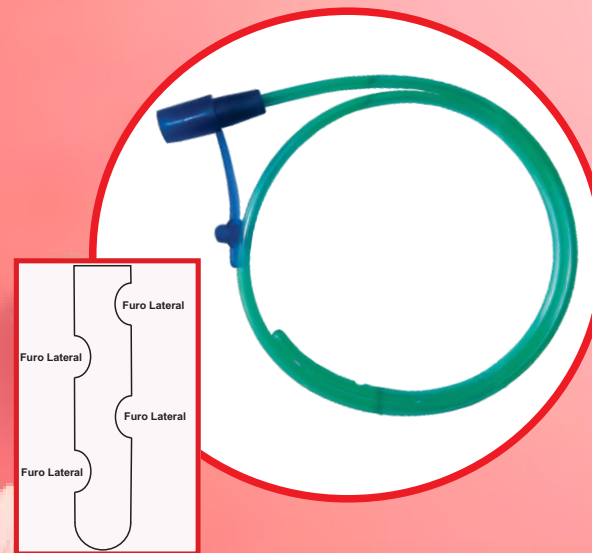
**CATETER NASAL OXIGÊNIO**

-Destinado a aplicação de oxigênio nos pulmões do paciente combatendo a deficiência de oxigênio facilitando a expectoração, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 40 cm cada unidade, verde, produto transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570002**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

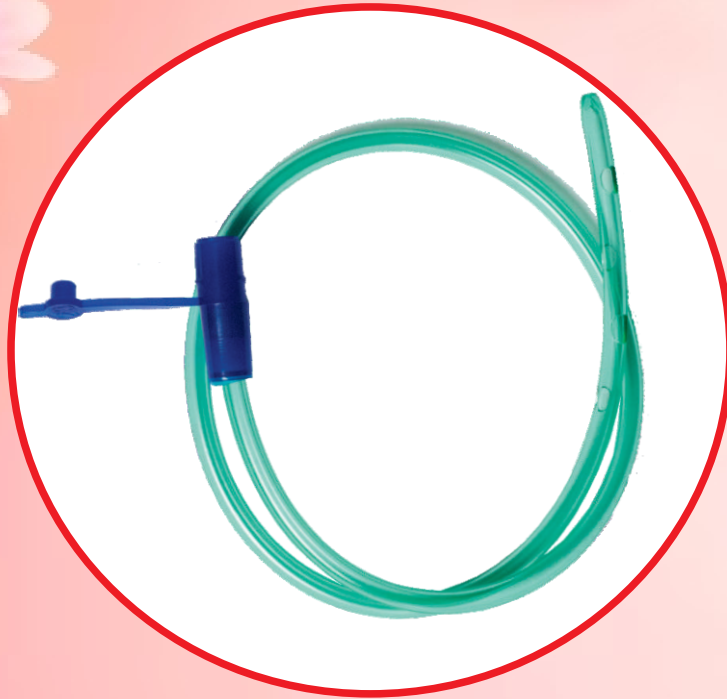

### CATETER NASAL NEO NATAL E INFANTIL

Cateter utilizado para administrar concentrações baixas e moderadas de oxigênio medicinal, é confeccionado em PVC (policloreto de vinil) cristal, com maior flexibilidade, uso NEO NATO E INFANTIL, verde, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570002**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



## SAC

[sac@medsonda.com.br](mailto:sac@medsonda.com.br)  
(43) 3512 2800



**EXTENSOR PARA CATETER DE INFUSÃO**

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), transparente, flexível e atóxico.

**EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE.**

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163579003**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**EXTENSOR PARA CATETER INFUSÃO COM LUER ROTATIVO**

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), com calibre na, transparente, flexível e atóxico.

**EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE.**

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163579003**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



## EXTENSOR CATETER INFUSÃO COM CORTA FLUXO

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), transparente, flexível e atóxico.

**EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO  
POR GRAVIDADE.**

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163579003**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

## EXTENSOR CATETER INFUSÃO COM LUER ROTATIVO E CORTA FLUXO

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), transparente e flexível, transparente, flexível e atóxico.

**EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO  
POR GRAVIDADE.**

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163579003**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

## EXTENSOR CATETER INFUSÃO NEO NATO

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão, é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), transparente e flexível com calibre na opção: neo nato, atóxico.

**EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE INFUSÃO  
POR GRAVIDADE.**

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163579003**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

## EXTENSOR CATETER INFUSÃO

-Extensor da linha de infusão, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), transparente e flexível com calibre na opção: infantil, atóxico.

**EXTENSOR UTILIZADO PARA EQUIPOS DE  
INFUSÃO POR GRAVIDADE.**

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163579003**

**EXTENSOR CRISTAL ASPIRAÇÃO**

-Extensor para aspiração cirúrgica, propicia maior liberdade de movimento e manipulação, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) com adaptador anelado ou ponteiros para adaptação, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA N° 80163570045**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



**ANELADO**



**PONTEIRA**

**EXTENSOR PARA CATETER OXIGÊNIO**

-Oxigênio verde é destinada a prolongar a tubulação de pacientes usuários de cateter tipo sonda, confeccionada de tubo PVC, verde, com conector anelado, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA N° 80163570007**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**COM LUER  
SLIP****EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PARTICULAS ENT. DE AR INJ. LAT. VALVULADO**

Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante que se adapta com facilidade a qualquer frasco, ampola, bolsa, com câmara de macro gotejamento flexível, modelo com filtro e injetor lateral valvulado.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**

**COM LUER  
ROTATIVO**

Saúde



Compulsório



Saúde



Compulsório

**COM LUER  
SLIP****EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PARTICULAS ENT. DE AR INJ. LAT. VALVULADO**

Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante que se adapta com facilidade a qualquer frasco, ampola, bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível, modelo com filtro e injetor lateral valvulado.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**

**COM LUER  
ROTATIVO**

Saúde



Compulsório



Saúde



Compulsório



CONFIRA ABAIXO NOSSA LINHA DE EQUIPOS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MACRO GOTAS.

**APROVADOS DEVIDAMENTE PELA PORTARIA Nº 461 DE DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA EQUIPOS DE USO ÚNICO DE TRANSFUSÃO, INFUSÃO GRAVITACIONAL E DE INFUSÃO PARA USO COM BOMBA DE INFUSÃO - CONSOLIDADO.**

**EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PARTICULAS E CONECTOR LUER SLIP**



-Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola /bolsa, com câmara de macro gotejamento flexível, modelo com filtro de partículas.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**



**EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PARTICULAS INJ. LAT. CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, contém injetor lateral que permite administrar múltiplos medicamentos.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**


**EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PARTICULAS ENT. DE AR CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, com entrada de ar.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**



**EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PART. INJ. LAT. ENT. AR CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco/ampola/bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, contém injetor lateral que permite administrar múltiplos medicamentos.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**

**EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO  
PARTICULAS ENT. DE AR E CONECTOR LUER ROTATIVO**

-Equipo utilizado para infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, com entrada de ar, contém injetor lateral que permite administrar múltiplos medicamentos.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**



CONFIRA ABAIXO NOSSA LINHA DE EQUIPOS DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MICRO GOTAS.

**APROVADOS DEVIDAMENTE PELA PORTARIA Nº 461 DE DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA EQUIPOS DE USO ÚNICO DE TRANSFUSÃO, INFUSÃO GRAVITACIONAL E DE INFUSÃO PARA USO COM BOMBA DE INFUSÃO - CONSOLIDADO.**

**EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PARTICULAS CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco/ampola/bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**



**EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PARTICULAS INJ. LAT. CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante trifacetado que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**


**EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PARTICULAS ENT. DE AR CONECTOR LUER SLIP**

-Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante trifacetado que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível com injetor lateral para administrar vários medicamentos.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**



**EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PARTICULAS ENT. AR INJ. LAT. LUER SLIP**

-Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível, entrada de ar e injetor lateral.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**

**EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL  
FILTRO PART. ENT. DE AR INJ. LAT. CONEC. LUER ROT.**

-Equipo utilizado para a infusão de soro. Ponta perfurante trifacetada que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de micro gotejamento flexível, entrada de ar, injetor lateral e conector luer rotativo.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**PRODUTO LIVRE DE LATEX**



**EQUIPO VETERINÁRIO**

- Equipo de infusão por gravidade com ou sem injetor lateral, para administração de medicamentos veterinários, com ponta perfurante, controle de fluxo e câmara de gotejamento transparente.

**PRODUTO ESTÉRILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO**

**ANVISA Nº ISENTO DE REGISTRO**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**2 VIAS****MEDVIAS 2 E 4 VIAS CORTA FLUXO TAMPA RESERVA E CONECTOR LUER ROTATIVO**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570041**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

**4 VIAS**

**SEM CORTA  
FLUXO****MEDVIAS COM 2 VIAS**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570041**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

**COM CORTA  
FLUXO****SEM CORTA  
FLUXO****MEDVIAS COM 4 VIAS**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570041**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA  
EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

**COM CORTA  
FLUXO**

**SEM CORTA  
FLUXO****MEDVIAS COM 2 VIAS NEO NATO**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570041**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

**COM CORTA  
FLUXO****SEM CORTA  
FLUXO****MEDVIAS COM 4 VIAS NEO NATO**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570041**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**COM CORTA  
FLUXO**

**COM LUER  
ROTATIVO****NEO NATO  
LUER SLIP****MEDVIAS 2 E 4 VIAS CORTA FLUXO  
VÁLVULADO**

- Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas e scalp.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570041**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**MODELO I****EQUIPO PARA CARBOXITERAPIA**

- Equipamento usado para estética não cirúrgica, na qual o gás carbônico é injetado utilizando-se de aparelho com agulha muito fina indicada para o combate da celulite, estrias, flacidez, gordura localizada, olheiras, rugas, micro varizes.

-Esterilizado por óxido de etileno.

**ANVISA Nº 80163579004**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

**MODELO II****Conector Escalonado****EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL**

-Produto destinado à nutrição enteral. Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa. Sua câmara de gotejamento é macro flexível nos modelos com conector luer slip e escalonado.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570026**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**Conector Luer Slip**

**EQUIPO PRESSÃO VENOSA**

-Equipo pressão venosa central P.V.C, estéril com câmara gotejadora e tubo interligado em forma de Y, pinça tipo rolete, acompanha fita graduada adesiva. E embalado individualmente, P.G.C de 1,80cm e fita métrica de 40cm.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA N° 80163570044**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**EQUIPO TRANFERIDOR SISTEMA FECHADO**

- Destinado a utilização para transferência e misturar soluções parenterais em sistema fechado, com duas pontas perfurantes com protetor.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA N°80163570027**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA  
EMBALADO EM TERMOFORMADORA**



**EQUIPO IRRIGADOR SISTEMA  
FECHADO 10CM**

-Dispositivo para irrigação ou transferência de soluções parenterais, para uso em frascos de sistema fechado, com uma ponta perfurante padrão ISO com protetor e outra ponta com protetor que garanta a oclusão do sistema após o uso; único canal para fluxo do líquido e pega ergonômica para manipulação.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570050**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA  
EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

**DEVOLUÇÕES**

“DEVOLUÇÕES, TROCAS E CANCELAMENTOS SOMENTE SERÃO ACEITOS COM MANIFESTAÇÃO ATÉ 7 DIAS APÓS DATA DE RECEBIMENTO, SALVO MERCADORIAS COM DESVIO DE QUALIDADE CONFIRMADOS E AUTORIZADOS PREVIAMENTE PELA MEDSONDA”

**SAC**

[sac@medsonda.com.br](mailto:sac@medsonda.com.br)  
(43) 3512 2800

**EQUIPO IRRIGADOR SISTEMA FECHADO**

- Dispositivo para irrigação, com ponta perfurante padrão ISO, com protetor e tampa luer lock.
- Embalagem individual, abertura em pétala, esterilizada em óxido de etileno, com data de esterilização, prazo de validade e registro em

**ANVISA Nº 80163570050****PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA****EMBALADO EM TERMOFORMADORA****FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL**


- Os frascos para administração de nutrição enteral **MEDSONDA** são desenvolvidos em polietileno de alta qualidade, graduados com escala e com trava de segurança e alça de sustentação.
- Artigo médico-hospitalar de uso único, indicado para alimentação enteral de pacientes impossibilitados de deglutir o alimento.

Frasco confeccionado em PE de 300ml graduado.

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL****ANVISA Nº 80163570036****PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**EQUIPO PARA ARTROSCOPIA**

- Utilizado para irrigar com solução fisiológica o órgão a ser submetido à Artroscopia.
- Produto composto por extensões em PVC cristal atóxico, conectores em "Y", clamp, corta fluxo em todas as vias.
- Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

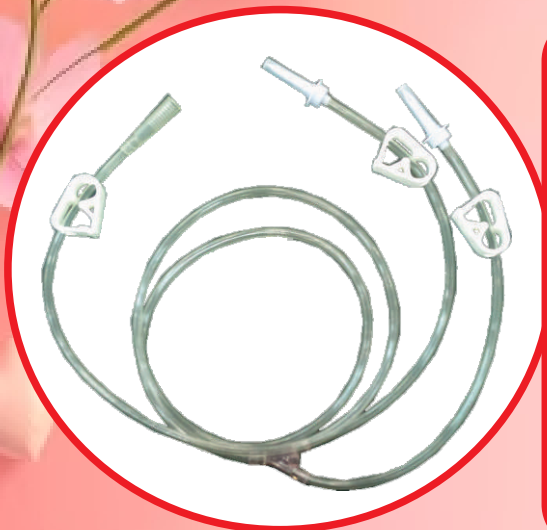**ANVISA Nº 80163570034****PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA****LUER ROTATIVO****EQUIPO MACRO FLEX. INJ. LAT. ENT. AR FOTOSSENSÍVEL****LUER SLIP**

-O Equipo de infusão gravitacional fotossensível é um produto foto-protetor, ele é indicado para a infusão de medicamentos, sensíveis a luz, os mesmos sofrem alterações em suas propriedades originais sob a ação, dos raios ultra violetas da luz, possui ponta perfurante que se adapta com facilidade a qualquer frasco / ampola / bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, contém injetor lateral e filtro particula, entrada de ar hidrofóbica acompanha capa para frascos que contenham soluções fotossensíveis.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570037****PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA****CAPA****CAPA**


## EXTENSOR CATETER INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL

-O Extensor Fotossensível é um produto foto-protetor, ele é indicado para extensão de equipos onde sua propriedade é a infusão de medicamentos fotossensíveis, ou seja sensíveis a luz, propicia maior liberdade de movimento e manipulação do sistema de infusão, é flexível com calibre na opção, adulto Fr12.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570032**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

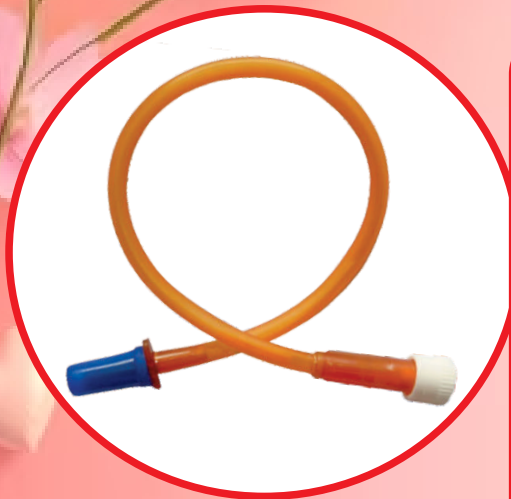

### 2 VIAS CORTA FLUXO



### MEDVIAS 2 E 4 VIAS FOTOSSENSÍVEL


-Extensor fotossensível, utilizado para multiplicação à via de acesso, permitindo assim, a infusão simultânea de 2 a 4 tipos de medicamentos sensíveis a luz, embalado individualmente, esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com especificações a critério de sua utilização.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570039**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA  
EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

### 4 VIAS CORTA FLUXO

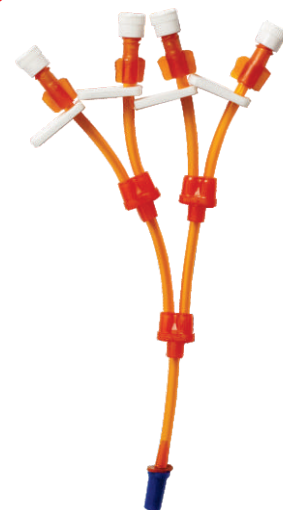


## ROMPEDOR PARA MEMBRANA AMINIÓTICA 27CM

-O perfurador de membrana amniótica oferece um método seguro e confortável para romper a membrana amniótica.  
-Com 27cm, possui ponta arredondada e protegida.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163579006**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

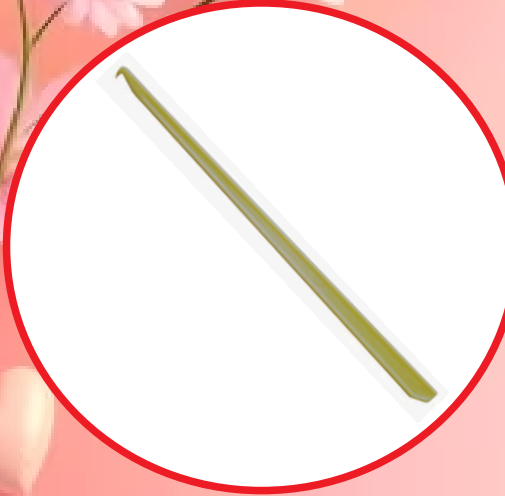

## DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM EXTENSÃO

- Indicado para coleta da urina de pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária.

**ANVISA Nº 80163570030 - Não Estéril**  
**ANVISA Nº 80163570028 - Estéril**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



**DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA  
URINÁRIA TIPO CONE**

- Indicado a coleta da urina de pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária.

**ANVISA Nº 80163570030 - Não estéril**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**BOLSA DRENAGEM URINA SISTEMA  
FECHADO PERNA 750ML**

-Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese de um paciente. Embalagem individual com todos os dados necessários ao usuário, tais como: identificação, marca, instrução de uso, número de lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570014**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



## COLETOR URINA SISTEMA ABERTO NÃO ESTÉRIL TIPO SACO 2.000ML

-Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese do paciente.

**ANVISA Nº 80163570046**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



## COLETOR URINA INFANTIL ADESIVO TIPO SACO 100ML

-Produto destinado a coletar material para exames, confeccionado com saco de 17cm de comprimento e 10 cm de largura, nos formatos masculino, feminino e unissex.

**ANVISA Nº 80163570029 - NÃO ESTÉRIL**  
**ANVISA Nº 80163570021 - ESTÉRIL**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



SEM PRESERVATIVO



COM PRESERVATIVO



COM ADAPTADOR



ADAPTADOR

### COLETOR SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1.200ML

- Produto destinado para drenagem de urina, embalagem individual com todos os dados necessários ao usuário como : Identificação, marca, instruções de uso, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.

**ANVISA N° 80163570008 - Sem Preservativo | Adaptador**

**ANVISA N° 80163570043 - Com Preservativo**

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



### **BOLSA DRENAGEM URINA SISTEMA FECHADO STANDARD**

-Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese de um paciente.  
-Embalagem individual com todos os dados necessários ao usuário, tais como: identificação, marca, instrução de uso, número de lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570014**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



### **BOLSA DRENAGEM DE URINA COM CÂMARA DE PASTEUR 2.000ML**

-Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese de um paciente possui câmara de PASTEUR.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570014**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

## COLETOR SISTEMA ABERTO TIPO BOLSA 1.500ML

-Produto destinado ao controle de fluxo de drenagem, quando se requer um controle aproximado na diurese de um paciente.

Produto NÃO ESTÉRIL

**ANVISA Nº 80163570047**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



## BOLSA PARA COLOSTOMIA

-Produto destinado a utilização da saída de dejetos fecais no final do intestino, que está com sua saída diferente do reto, devido a realização de cirurgia corretiva de tumores ou obstruções que exigem manipulação, confeccionado com furos nos tamanhos de 30, 50 e 63mm com capacidade de 200ml.

Produto NÃO ESTÉRIL, ANTI ALÉRGICO.

**ANVISA Nº 80163570013**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**



**TAMPA LUER MED**

-É uma tampa de proteção luer lock macho adaptado aos conectores luer lock fêmea com finalidade de vedação.

**ABERTURA EM PÉTALA**

**ANVISA N° 80163570020**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**EMBALADO EM TERMOFORMADORA**

**PRENDEDOR UMBILICAL**

-Acessório utilizado para prender o cordão umbilical de recém nascidos, após o parto, uso profissional, e confeccionado em nylon, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA N° 80163570015**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**





## ESPÉCULO

-Produto destinado a realização de exames ginecológicos, fabricado em polietileno cristal nos tamanhos P , M e G, permite excelente transparência e transmissão luminosa, estrutura anatômica de contornos lisos e regulares, estéril e descartável.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163579002**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**IPI INCLUSO**



## PINÇA DE CHERON

- A Pinça de Cheron é fabricada em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda.

**ANVISA Nº 80163579007**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**ISOLADOR DE PRESSÃO**

-É um acessório que tem como função transmitir a pressão da linha de sangue arterial ou venosa ao monitor de diálise, evitando assim a contaminação pelo sangue do paciente, é confeccionado em PVC, transparente, atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

**ANVISA Nº 80163570016**

**PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA**

**DEVOLUÇÕES**

“DEVOLUÇÕES, TROCAS E CANCELAMENTOS SOMENTE SERÃO ACEITOS COM MANIFESTAÇÃO ATÉ 7 DIAS APÓS DATA DE RECEBIMENTO, SALVO MERCADORIAS COM DESVIO DE QUALIDADE CONFIRMADOS E AUTORIZADOS PREVIAMENTE PELA MEDSONDA”

**ENTREGA**

**PRAZO E CONDIÇÕES DE  
ENTREGA  
SOB  
CONSULTA**