

**COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000 ML
ANVISA N°80163570046**



FINALIDADE:

Sistema de coleta de urina durante uma sondagem uretral, em sistema aberto.

COMPOSIÇÃO:

1. Saco plástico translúcido atóxico, com capacidade de 2000 ml. Confeccionado em Polietileno inodoro e resistente.
2. Escala volumétrica impressa no coletor de 100 em 100 ml.
3. Local para anotações de dados do paciente.
4. Cordão para sustentação e manipulação do coletor.
5. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo Ilustrativo

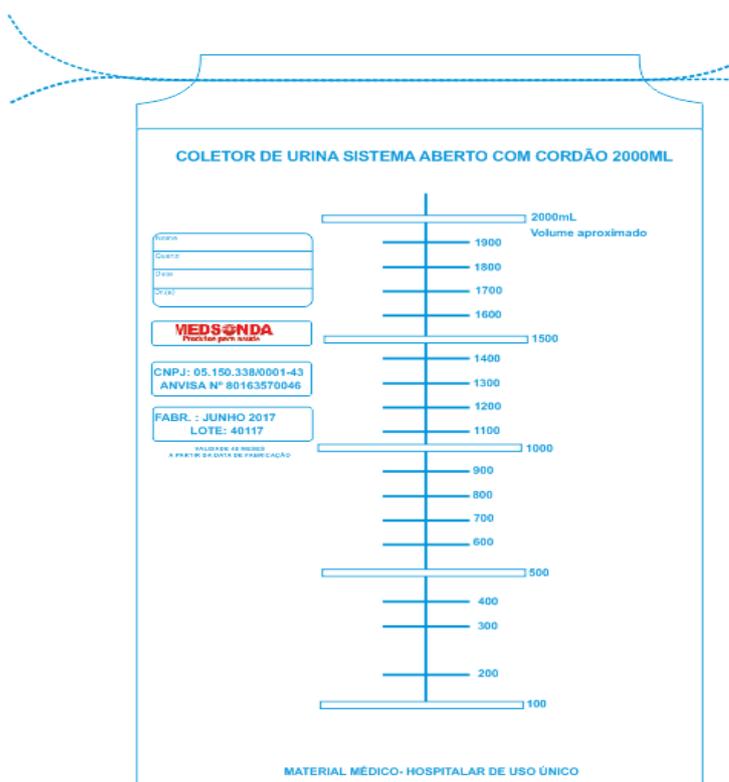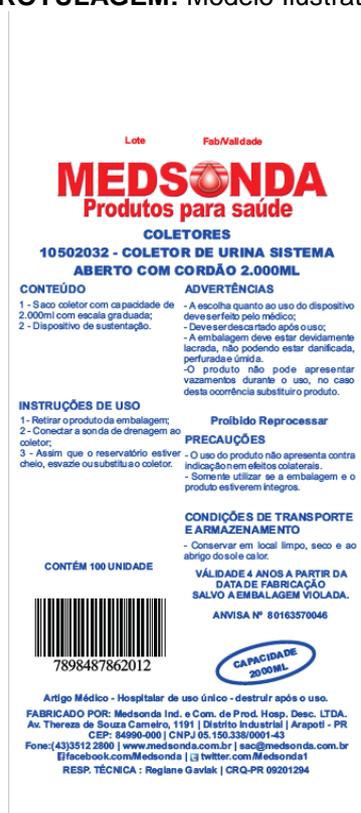

EMBALAGEM:

100 unidades por embalagem plástica selada.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2016	00	Joelma C. Brizola	Elaboração
06/2017	01	Joelma C. Brizola	Alteração do registro na Anvisa
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex